



DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



DJO FRANCE S.A.S.
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre • France
www.DJOglobal.fr

13-6796 Rev D

Veinax



AIRCAST®

Veinax

Bas médicaux de compression

CLASSE I **(10-15 mm Hg)**

Indications

- Atteinte du système veineux superficiel
- Troubles fonctionnels (fatigabilité, lourdeurs, brûlures, chaleur)
- Varices simples sans œdème
- Prévention (voyages et longs trajets, phlébites et œdèmes)

CLASSE II **(15-20 mm Hg)**

Indications

- Atteinte du système veineux superficiel et extra fascial
- Troubles fonctionnels (fatigabilité, lourdeurs, brûlures, chaleur)
- Varices avec œdème
- Phlébites superficielles
- Post-sclérothérapie
- Prévention (voyages et longs trajets, phlébites et œdèmes)
- Surcharge pondérale
- Professions en station debout prolongée

CLASSE III **(20 - 36 mm Hg)**

Indications

- Prévention des TVP (Thromboses Veineuses Profondes) chez les sujets alités
- Atteinte du système veineux profond
- Post-chirurgie (1 mois)
- Varices compliquées de troubles trophiques
- Phlébites profondes
- Syndromes post-phlébitiques

Contre-indications

- Artériopathie des membres inférieurs
- Micro-angiopathie diabétique
- Ulcères artériels
- Œdèmes systémiques

Composition

Microtrans/Fantaisie/Transparent:

Elasthanne/Polyamide

Coton:


Elasthanne/Polyamide/Coton

Pour usage sur un seul patient uniquement

Nos mi-bas, bas et collant sont fabriqués avec un niveau de qualité supérieure pour atteindre un niveau de transparence inégalé. Néanmoins, il est très important de respecter le protocole de mise en place afin d'éviter d'abîmer le produit.

COMMENT ENFILER VOS BAS ?

1. Avant de mettre les bas, il est opportun de tenir les jambes au moins 5 minutes en position plus élevée que le tronc pour favoriser le reflux sanguin. Nous préconisons de les mettre le matin avant de descendre du lit.
2. Mettre les bas sur la jambe bien sèche en employant, éventuellement, un peu de talc.
3. Retourner les bas jusqu'au talon.
4. Glisser le pied.
5. Dérouler le bas sur la jambe en l'accompagnant sans tirer sur le tissu..

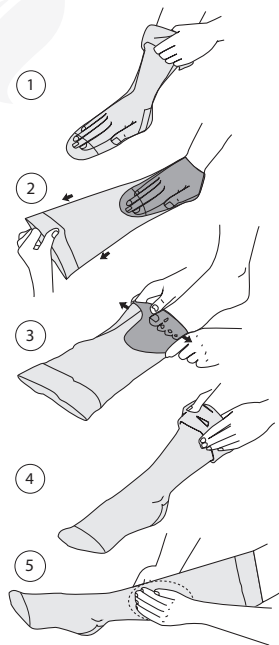

Lors de l'enfilage de vos bas, faites attention de ne pas accrocher le produit avec vos ongles ou bague. Ne pas tirer sur la partie de l'antiglisse pour éviter toute détérioration.

Conseils d'entretien :

1. Laver à l'eau à une température ne dépassant pas les 40°C.
2. Employer de préférence un savon neutre (l'emploi de détachant est déconseillé).
3. Rincer abondamment avec de l'eau tiède.
4. Ne pas tordre.
5. Ne pas sécher au soleil ou près de sources de chaleur

Veinax

EN

Medical compression hosiery

CLASS I **(10-15 mmHg)**

Indications

- Diseases of the superficial venous system
- Functional disorders (tired, aching, heavy legs)
- Superficial varicosis without oedema
- Prevention (travel & long journeys, phlebitis and oedema)

CLASS II **(15-20 mmHg)**

Indications

- Diseases of the superficial & fascial venous system
- Functional disorders (tired, aching, heavy legs)
- Varicosis with oedema
- Superficial thrombophlebitis
- Post-sclerotherapy
- Prevention (travel & long journeys, phlebitis and oedema)
- Overweight
- Professions requiring long periods of standing

CLASS III **(20-36 mmHg)**

Indications

- Prevention of deep vein thrombosis in patients confined to bed rest
- Diseases of the deep venous system
- Post-operatively (1 month)
- Varicose veins complicated by atrophy
- Severe postphlebotic cases
- Postphlebotic syndrome

Contra-indications

- Advanced peripheral obstructive arterial disease
- Severe neuropathy (diabetic)
- Arterial ulcers
- Systemic oedema

Composition

Microtrans/Fantaisie/Transparent:

Elastane/Polyamide

Coton:

Elastane/Polyamide/Cotton


For Single Patient Use Only

Our knee high stockings, hold ups and tights are manufactured to a high quality, attaining an unmatched level of transparency. Nevertheless, it is important to take care when handling the stockings to ensure that they do not become damaged.

HOW DO YOU PUT ON YOUR STOCKINGS?

Prior to applying the stockings, it is advisable to elevate the legs above the heart for at least 5 minutes, to ensure blood return. Ideally, the stockings should be applied in the morning before getting up.

1. Slip the hand into the stocking.
2. Turn the stocking inside out, keeping hold of the heel with your hand.
3. Slip your foot in gently up to the top of the stocking. Ensure that the heel is positioned correctly avoiding any creases.
4. Gently slide the stocking up the leg and adjust accordingly.
5. Smooth out any wrinkles along the leg.

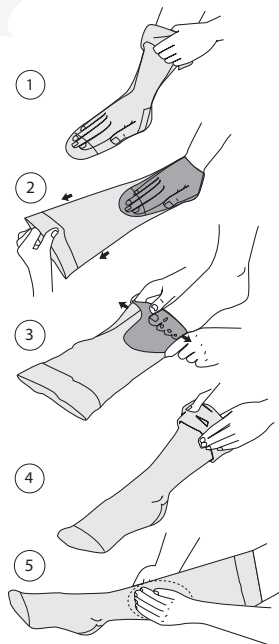

While putting on your stockings, take care not to catch the material with your nails or rings. To avoid tearing, be careful not to pull on the silicone band.

Care Instructions:

1. Delicate wash up to 40°C.
2. Use mild soap, do not use chlorine bleach.
3. Rinse well with tepid water.
4. Do not tumble dry.
5. Dry flat, away from the sun or direct heat.

Veinax

Calze a compressione medicale

CLASSE I **(10-15 mm Hg)**

Indicazioni

- Disturbi del sistema venoso superficiale
- Disordini funzionali (gambe stanche, doloranti, pesanti)
- Vene varicose superficiali senza edema
- Uso preventivo (lunghi viaggi, flebiti ed edema)

CLASSE II **(15-20 mm Hg)**

Indicazioni

- Disturbi del sistema venoso superficiale e fasciale
- Disordini funzionali (gambe stanche, doloranti, pesanti)
- Vene varicose con edema
- Tromboflebiti superficiali
- Dopo trattamento di scleroterapia
- Uso preventivo (lunghi viaggi, flebiti ed edema)
- Sovrappeso e obesità
- Professioni che richiedono lunghi periodi di tempo in piedi

CLASSE III **(20-36 mm Hg)**

Indicazioni

- Prevenzione della trombosi venosa profonda in pazienti allettati
- Disturbi del sistema venoso profondo
- Utilizzo post-operatorio (1 mese)
- Vene varicose con complicanze di atrofia
- Casi gravi postflebitici
- Sindrome post-flebitica

Controindicazioni

- Ostruzione delle arterie periferiche
- Severa neuropatia (diabete)
- Ulcere arteriose
- Edema sistemico

Composizione

Microtrans/Fantaisie/Transparent:

Elastan/Poliammide

Coton:


Elastan/Poliammide/Cotone

Per l'uso su un solo paziente

Le nostre calze (gambaletti, autoreggenti e collant) sono prodotte con materiali di alta qualità e si attengono ad un livello di trasparenza senza pari. Nonostante ciò, è importante prestare la massima cura quando si maneggiano le calze per evitare che vengano danneggiate.

COME INDOSSARE LE CALZE?

1. Prima di indossare le calze, è consigliabile tenere le gambe elevate per almeno 5 minuti, per agevolare il ritorno venoso. L'ideale sarebbe indossare le calze al mattino prima di alzarsi dal letto.
2. Infilare la mano nella calza fino al tallone.
3. Afferrare il tallone e rivoltare la calza.
4. Infilare il piede nella calza e posizionare correttamente il tallone.
5. Srotolare delicatamente la calza fino alla gamba senza tirare.

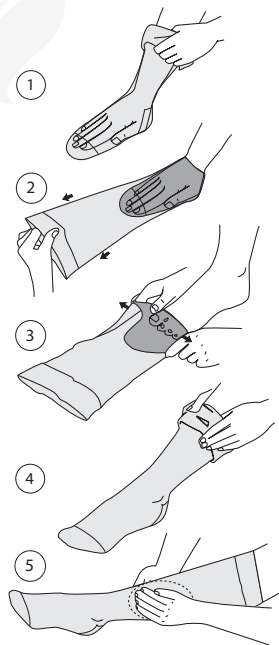

Al momento di indossare le calze, prestare attenzione a unghie ed anelli. Per evitare strappi, non tirare la fascia di silicone.

Istruzioni per il lavaggio:

1. Lavaggio delicato a 40°
2. Lavare con sapone neutro, non candeggiare
3. Risciacquare con cura in acqua tiepida
4. Non utilizzare l'asciugatrice
5. Asciugare lontano dal sole o dal calore diretto

Veinax

ES

Medias de compresión médica

Clase I (10-15mmHg)

Indicaciones

- Patologías del sistema venoso superficial
- Desordenes funcionales (cansancio, dolor, piernas pesadas)
- Varices superficiales sin edema
- Preventivas (viajes y trayectos largos, flebitis y edema)

Clase II (15-20mmHg)

Indicaciones

- Patologías del sistema venoso fascial y superficial
- Desordenes funcionales (cansancio, dolor, piernas pesadas)
- Varices con edema
- Tromboflebitis superficial
- Post-escleroterapia
- Preventivas (viajes y trayectos largos, flebitis y edema)
- Sobrepeso
- Profesiones que requieran permanecer de pie durante un periodo largo de tiempo

Clase III (20-36mmHg)

Indicaciones

- Prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes encamados
- Patologías del sistema venoso profundo
- Post-operatorio (1 mes)
- Venas varicosas complicadas por atrofia
- Post-flebitis severa
- Síndrome post-flebitico

Contraindicaciones

- Patología arterial obstructiva periférica avanzada
- Neuropatía severa (diabetes)
- Úlceras arteriales
- Edema sistémico

Composición

Microtrans/Fantaisie/Transparent:

Elastano/Poliamida

Coton:


Elastano/Poliamida/Algodón

Producto para un solo paciente

Nuestros pantys, medias y calcetines tienen una fabricación de alta calidad, alcanzando un incomparable nivel de transparencia. Sin embargo, es importante tener cuidado al manipular las medias para asegurar que no se estropeen.

¿CÓMO PONERSE LAS MEDIAS?

1. Antes de ponerse las medias, es aconsejable elevar las piernas por encima del corazón durante al menos 5 minutos, para asegurar el retorno de la sangre. Preferiblemente, las medias deben ponerse por la mañana antes de levantarse.
2. Ponga la mano dentro de la media y sujétela del talón.
3. Gire a la media del revés manteniendo el talón bien sujeto.
4. Ponga el pie apretando el máximo hacia la parte superior y coloque correctamente el talón.
5. Gire suavemente la media hacia arriba sin estirar de ella.

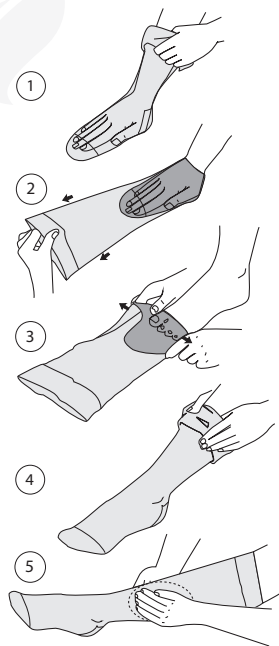

Mientras se pone las medias, tenga cuidado de no enganchar el tejido con las uñas o anillos. Para evitar que se rompa, tenga cuidado de no tirar de la banda de silicona.

Instrucciones de Mantenimiento:

1. Lavado delicado hasta 40°.
2. Use un jabón suave, no usar lejía a base de cloro .
3. Enjuague bien con agua tibia.
4. No secar en secadora.
5. Póngalas a secar estiradas apartadas de la luz solar directa o de una fuente de calor.

Veinax

DE

Medizinische Kompressionsstrümpfe

Klasse I (10-15 mmHg)

Indikationen

- Erkrankungen des oberflächlichen Venensystems
- Funktionelle Störungen (Ermüdung, Schmerzen, schwere Beine)
- Oberflächliche Varikosis ohne Ödem
- Prävention (lange Reisen, Phlebitis und Ödem)

Klasse II (15-20 mmHg)

Indikationen

- Erkrankungen des oberflächlichen & faszialen Venensystems
- Funktionelle Störungen (Ermüdung, Schmerzen, schwere Beine)
- Varikosis mit Ödem
- Oberflächliche Thrombophlebitis
- Nach Sklerotherapie
- Prävention (lange Reisen, Phlebitis und Ödem)
- Übergewicht
- Berufe, die langes Stehen erfordern

Klasse III (20-36 mmHg)

Indikationen

- Prävention von tiefer Venenthrombose bei bettlägerigen Patienten
- Erkrankungen des tiefen Venensystems
- Nach Operationen (1 Monat)
- Varikose mit Komplikation aufgrund von Atrophie
- Schwere postphlebetische Fälle
- Postphlebitisches Syndrom

Kontraindikationen

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Schwere Neuropathie (diabetisch)
- Arterielle Ulzera
- Systemisches Ödem

Material

Microtrans/Fantaisie/Transparent:

Elastan/Polyamid

Coton:


Elastan/Polyamid/Baumwolle

Nur zum Gebrauch an einem einzigen Patienten

Unsere Kniestrümpfe, halterlosen Strümpfe und Strumpfhosen werden in sehr hoher Qualität hergestellt. Bitte beachten Sie dennoch eine vorsichtige Handhabung, um eine lange Haltbarkeit der Strümpfe zu gewährleisten.

WIE WERDEN DIE STRÜMPFE ANGEZOGEN?

1. Es ist ratsam, Ihre Beine vor dem Anziehen der Kompressionsstrümpfe ca. 5 Minuten hochzulagern, um einen Rückfluss des Blutes sicherzustellen. Idealerweise sollten die Strümpfe morgens vor dem Aufstehen angezogen werden.
2. Schieben Sie die Hand in die Strümpfe und greifen Sie das Fersenteil.
3. Drehen Sie die Strümpfe auf Links. Halten Sie das Fersenteil fest.
4. Gleiten Sie mit dem Fuß bis zum Anfang in die Strümpfe und positionieren Sie das Fersenteil korrekt.
5. Rollen Sie die Strümpfe vorsichtig das Bein hinauf, ohne am Material zu ziehen.

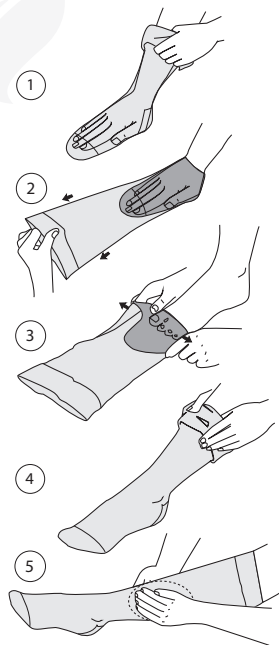

Während Sie Ihre Strümpfe anziehen, sollten Sie darauf achten, dass Sie mit Ihren Fingernägeln oder Ringen nicht am Material hängenbleiben. Um zu verhindern, dass die Strümpfe reißen, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht am Silikonband ziehen.

Reinigungsanweisung:

1. Feinwäsche bis 40 °C
2. Milde Seife verwenden. Keine Bleichmittel auf Chlorbasis verwenden.
3. Mit lauwarmem Wasser gut ausspülen.
4. Nicht Trocknergeeignet.
5. Flach liegend trocknen und vor Sonnenlicht oder direkter Hitzeeinstrahlung schützen.

Veinax

Medische compressiekousen

Klasse I (10-15 mmHg)

Indicaties

- Aandoeningen van het oppervlakkige veneuze systeem
- Functionele stoornissen (vermoeide, pijnlijke, zware benen)
- Oppervlakkige spataders zonder oedeem
- Preventie (op reis & lange reistijden, flebitis, oedeem)

Klasse II (15-20 mmHg)

Indicaties

- Aandoeningen van het oppervlakkige & fasciale veneuze systeem
- Functionele stoornissen (vermoeide, pijnlijke, zware benen)
- Spataders met oedeem
- Oppervlakkige tromboflebitis
- Na sclerotherapie
- Preventie (op reis & lange reistijden, flebitis, oedeem)
- Overgewicht
- Langdurig rechtstaan

Klasse III (20-36 mmHg)

Indicaties

- Preventie van diepe veneuze trombose bij bedlegerige patiënten
- Aandoeningen van het diepe veneuze systeem
- Postoperatief (1 maand)
- Spataders met huidveranderingen (atrofie)
- Ernstige postflebitis
- Postflebitisch syndroom

Contra-indicaties

- Ernstige obstructieve arteriële aandoening
- Ernstige (diabetische) neuropathie
- Arteriële zweren
- Systemisch oedeem

Samenstelling

Microtrans/Fantaisie/Transparent:
Elastaan/Polyamide

Coton:


Elastaan/Polyamide/Katoen

Uitsluitend individueel gebruik

Onze knie-, dij- en pantykousen voldoen aan hoge kwaliteitsnormen en hebben een ongeëvenaarde transparantie. Het is echter belangrijk de kousen met de nodige zorg te behandelen om beschadigingen te vermijden.

HOE TREKT U DE KOUSEN AAN?

1. Alvorens de kousen aan te trekken is het raadzaam om gedurende minstens 5 minuten met de benen omhoog te liggen, boven hartniveau, om de terugkeer van het bloed uit de benen te verzekeren. Idealiter worden de kousen aangetrokken 's morgens vóór het opstaan.
2. Steek uw hand in de kous en grijp de hiel vast.
3. Keer de kous binnenstebuiten terwijl u de hiel blijft vasthouden.
4. Steek uw voet in de kous tot aan het teennuiteinde en zorg dat de hiel op de correcte plaats zit.
5. Rol de kous voorzichtig omhoog over het been zonder aan het materiaal te trekken.

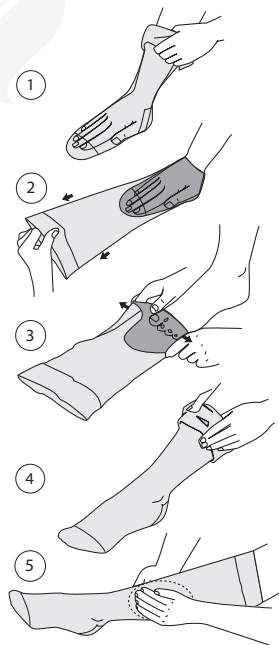

Zorg ervoor dat u tijdens het aantrekken van de kousen niet blijft haperen met uw nagels of juwelen. Trek niet aan de silicone band om scheuren te vermijden.

Richtlijnen voor verzorging:

1. Delicate was tot 40°C
2. Gebruik milde zeep, gebruik geen bleekmiddelen op basis van chloor.
3. Spoel grondig met lauw water
4. Droog niet in de droogtrommel
5. Laat plat drogen, uit de zon of directe hitte.

Veinax

DA

Medicinske støttestrømper

Klasse I (10-15mmHg)

Indikationer

- Sygdomme i det overfladiske venesystem
- Funktionsforstyrrelser (trætte, ømme, tunge ben)
- Overfladiske åreknuder uden væskeansamling
- Forebyggelse (rejser og lange ture, årebetændelse og væskeansamling)

Klasse II (15-20mmHg)

Indikationer

- Sygdomme i det overfladiske fascievenesystem
- Funktionsforstyrrelser (trætte, ømme, tunge ben)
- Åreknuder med væskeansamling
- Overfladisk årebetændelse
- Efter skleroterapi
- Forebyggelse (rejser og lange ture, årebetændelse og væskeansamling)
- Overvægt
- Professioner, der kræver, at man står op i lange perioder

Klasse III (20-36mmHg)

Indikationer

- Forebyggelse af dyb venetrombose hos sengeliggende patienter
- Sygdomme i det dybe venesystem
- Efter operation (1 måned)
- Åreknuder, der er kompliceret af atrofi
- Alvorlige tilfælde af postflebitis
- Postflebitissyndrom

Kontraindikationer

- Fremskreden perifer obstruktiv arteriel sygdom
- Alvorlig neuropati (diabetes)
- Arterielle sår
- Systemisk væskeansamling

Sammensætning

Microtrans/Fantaisie/Transparent:

Elastan/Polyamid

Coton:


Elastan/Polyamid/Bomuld

Må kun bruges til en enkelt patient

Vores knælange strømper, selvsiddende strømper og strømpebukser fremstilles i en høj kvalitet og har en uovertruffen gennemsigtighed. Det er ikke desto mindre vigtigt at udvise forsigtighed, når strømperne tages af og på, så de ikke beskadiges.

SÅDAN TAGES STRØMPERNE PÅ

1. Inden strømperne tages på, tilrådes det at løfte benene over hjertehøjde i mindst fem minutter for at sikre blodets tilbageløb. Ideelt set skal strømperne tages på om morgenen, inden man står op.
2. Sæt hånden ind i strømpen, og tag fat om hælen.
3. Vend vrangen ud på strømpen, mens der holdes fast i hælen.
4. Stik foden ud i spidsen af strømpen, og placer hælen korrekt.
5. Rul derefter forsigtigt strømpen op ad benet uden at trække i materialet.

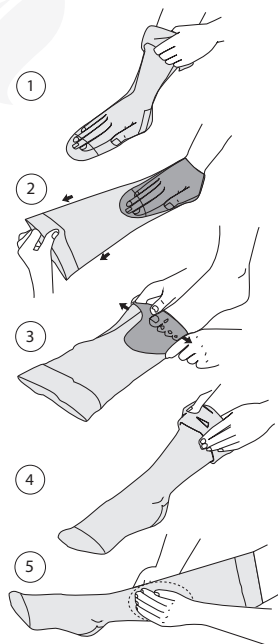

Når strømperne tages på, er det vigtigt at passe på, at negle og ringe ikke griber fat i materialet. Undgå at rive hul ved ikke at trække i silikonebåndet.

Rengøringsvejledning:

1. Skånevask ved op til 40 °
2. Anvend en mild sæbe, og undgå klorbaseret blegemiddel
3. Skyl godt med lunken vand
4. Må ikke tørretumbles.
5. Bør liggetørre. Undgå direkte sollys eller direkte varme.

Lääkinnälliset hoitosukat

Luokka I **(10-15 mmHg)**

Indikaatiot

- Pintalaskimoiden sairaudet
- Toimintahäiriöt (väsyneet, kipeät, raskaat jalat)
- Suonikohjut ilman turvotusta
- Ennaltaehkäiseminen (matkustus ja pitkät matkat, laskimotulehdus ja turvotus)

Luokka II **(15-20 mmHg)**

Indications

- Pinta- ja yhdyslaskimoiden sairaudet
- Toimintahäiriöt (väsyneet, kipeät, raskaat jalat)
- Suonikohjut, joihin liittyy turvotusta
- Pinnallinen laskimontukkotulehdus
- Skleroterapian jälkeen
- Ennaltaehkäiseminen n (matkustus ja pitkät matkat, laskimotulehdus ja turvotus)
- Ylipaino
- Ammatit, joissa on seisottava pitkiä aikoja

Luokka III **(20-36 mmHg)**

Indications

- Vuodelepoon jääneiden potilaiden syvälaskimotukoksen estäminen
- Syvien laskimoiden sairaudet
- Leikkauksen jälkeen (1 kk)
- Atrofian vaikeuttamat suonikohjut
- Vaikeat posttromboottiset tapaukset
- Posttromboottinen oireyhtymä

Kontraindikaatiot

- Edistynyt, tukkiva ääreisvaltimotauti
- Vaikea neuropatia (diabeettinen)
- Valtimohaavat
- Systeeminen turvotus

Koostumus

Microtrans/Fantaisie/Transparent:

Elastaani/Polyamidi

Coton:


Elastaani/Polyamidi/Puuvilla

Potilaskohtainen

Polvisukkamme, pitkät sukkamme ja sukkahousumme valmistetaan korkealaatuiseksi ja verrattoman läpinäkyviksi. Siitä huolimatta sukkia on tärkeää käsitellä huolellisesti, jotta ne eivät vahingoitu.

MITEN SUKAT PUETAAN JALKAAN?

1. Ennen sukkien pukemista neuvotaan jalat nostamaan sydämen yläpuolelle vähintään 5 minuutiksi, jotta veren paluuvirtaus varmistuu. Sukat tulee ihannetapauksessa pukea aamulla ennen sängystä nousemista.
2. Työnnä käsi sukkaan ja ota sen kantaosasta kiinni.
3. Käännä sukan sisäpuoli ulospäin pitäen kannasta kiinni.
4. Laita jalkaterä sukkaan ja aseta kantapää kohdalleen.
5. Rullaa sukka jalkaan varoen vetämästä kangasta.

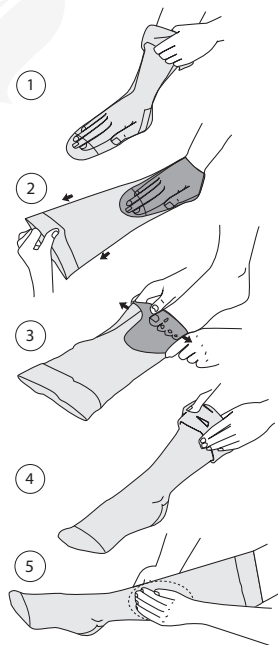

Kun puet sukkia jalkaan, varo, ettei kangas tartu kynsiin tai sormuksiin. Repeämisen välttämiseksi varo vetämästä silikoninauhasta.

Hoito-ohjeet:

1. Hienopesu enintään 40°
2. Käytä mietoa pesuainetta. Älä käytä kloorivalkaisuaineita.
3. Huuhtelee huolellisesti haalealla vedellä.
4. Älä rumpukuivaa.
5. Kuivaa tasaisella alustalla auringolta tai suoralta lämmöltä suojattuna.

Veinax

NO

Medisinske kompresjonsstrømper

Klasse I (10-15 mmHg)

Indikasjoner

- Sykdommer i det overfladiske venesystemet
- Funksjonelle lidelser (trøtthet, verking, tunge ben)
- Åreknuter i overflaten uten ødem
- Forebygging (reise og lange turer, flebitt og ødem)

Klasse II (15-20 mmHg)

Indikasjoner

- Sykdommer i det overfladiske venesystemet og venesystemet i fascia
- Funksjonelle lidelser (trøtthet, verking, tunge ben)
- Åreknuter med ødem
- Tromboflebitt i overflaten
- Postskleroterapi
- Forebygging (reise og lange turer, flebitt og ødem)
- Overvekt
- Yrker som krever lange perioder i oppreist stilling

Klasse III (20-36 mmHg)

Indikasjoner

- Forebygging av trombose i dyptliggende vener hos sengeliggende pasienter
- Sykdommer i det dyptliggende venesystemet
- Postoperativt (1 måned)
- Varikøse vener som har blitt komplisert av atrofi
- Alvorlige posttrombotiske tilfeller
- Posttrombotisk syndrom

Kontraindikasjoner

- Avansert perifer obstruktiv arteriesykdom
- Alvorlig nevropati (diabetisk)
- Arterielle sår
- Systemisk ødem

Sammensetning

Microtrans/Fantaisie/Transparent:

Elastan/Polyamid

Coton:

Elastan/Polyamid/Bomull

Skal kun brukes på én pasient

Våre knehøye strømper, hold-ups og strømpebukser produseres med høy kvalitet, noe som sikrer en uovertruffen grad av gjennomskiktighet. Det er likevel viktig å være forsiktig ved håndtering av strømper for å sikre at de ikke går i stykker.

HVORDAN TAR DU PÅ DEG STRØMPENE?


1. Før du tar på deg strømper, bør du heve benene over nivået til hjertet og holde dem der i minst 5 minutter for å sikre at blodet strømmer tilbake. Ideelt sett bør du ta på deg strømper på morgenen før du står opp.

2. Før hånden inn i strømpen, og ta tak i hælen.

3. Vreng strømpen mens du holder i hælen.

4. Plasser foten opp mot toppen, og plasser hælen riktig.

5. Rull strømpen forsiktig oppover benet uten å trekke i stoffet.

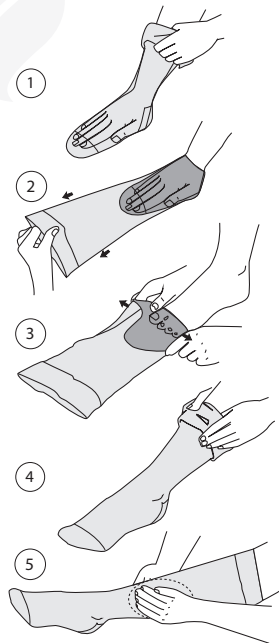

Når du tar på deg strømper, må du være forsiktig, slik at stoffet ikke setter seg fast i negler eller ringer. For å unngå at strømper går i stykker, må du passe på at du ikke trekker i silikonbåndet.

Stell:

1. Finvask på opptil 40 °
2. Bruk mild såpe. Ikke bruk klorbaserte blekemidler
3. Skyll godt i lunkent vann
4. Ikke bruk tørketrommel.
5. Tørk strømper flate, og hold dem borte fra sollys eller direkte varmekilder.

Veinax

SV

Medicinska kompressionsstrumpor

Klass I (10-15 mmHg)

Indikationer

- Sjukdomar i det ytliga venösa systemet
- Funktionshinder (trötthet, smärta, tunga ben)
- Ytlig varikos utan ödem
- Förebyggande (resor och längre transportsträckor, flebit och ödem)

Klass II (15-20 mmHg)

Indikationer

- Sjukdomar i det ytliga och fasciala venösa systemet
- Funktions störning (trötthet, smärta, tunga ben)
- Varicer (åderbräck) med ödem
- Ytlig tromboflebit
- Post-skleroterapi
- Förebyggande (ex resor och längre transportsträckor, flebit och ödem)
- Övervikt
- Yrken som kräver långa perioder ståendes

Klass III (20-36 mmHg)

Indikationer

- Förebyggande av djup ventrombos hos patienter som är sängliggandes
- Sjukdomar i det djupa venösa systemet
- Postoperativt (1 månad)
- Varicose (utvidgade) vener med komplikationer på grund av atrofi
- Allvarliga fall av postflebit
- Postflebit syndrom

Kontraindikationer

- Avancerad perifer obstruktiv artärsjukdom
- Allvarlig neuropati (diabetes)
- Arteriella sår
- Systemiskt ödem

Materialsammansättning

Microtrans/Fantaisie/Transparent:

Elastan/Polyamid

Coton:

Elastan/Polyamid/Bomull

För engångsbruk

Våra höga knästrumpor, hold-ups och tights är tillverkade i hög kvalitet och har en hög grad av transparens. Det är viktigt att de hanteras varsamt för att inte skadas.

HUR TAR DU PÅ DINA STRUMPOR?


1. Innan du tar på strumporna bör benen hållas ovanför hjärtnivå i minst 5 minuter för att säkerställa blodretur. Ta helst på dig strumporna innan du stiger upp på morgonen.

2. Trä in handen i strumpan och ta tag om hälen.

3. Vänd strumpan ut och in när du håller om hälen.

4. Sätt in tårna längst fram i strumpan och positionera hälen korrekt.

5. Rulla försiktigt upp strumpan längs med benet utan att dra i materialet.

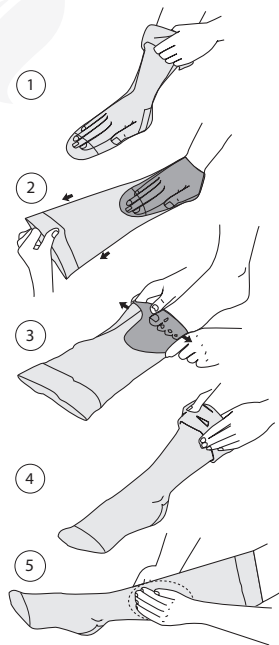

Var försiktig när du trär på strumporna så att du inte fastnar med naglar eller ringar i materialet. Dra inte i silikonbandet då det kan ge upphov till maskor och revor.

Skötsel:

1. Skonsam tvätt i upp till 40 °
2. Använd ett mildt tvättmedel utan blekmedel
3. Skölj noggrant med ljummet vatten
4. Får ej torktumlas.
5. Låt plantorka utan direktkontakt med solljus eller värme.

DJO GLOBAL

AUSTRALIA:

DJO Australia
PO Box 2057
Normanhurst
NSW 2076
AUSTRALIA

T: +1300 66 77 30

F: +1300 66 77 40

E: customerserviceau@

DJOglobal.com.

BENELUX:

DJO Benelux
Welvaartstraat 8
2200 Herentals
BELGIUM

T Belgium: 0800 18 246

T Netherlands: 0800 0229442

T Luxembourg: 8002 27 42

E: benelux.orders@

DJOglobal.com

CANADA:

DJO Canada
6485 Kennedy Road
Mississauga
Ontario
L5T 2W4
CANADA

T: +1 1866 866 5031

F: +1 1866 866 5032

E: canada.orders@

DJOglobal.com

CHINA:

DJO China
A312 SOHO ZhongShan Plaza
1055 W. ZhongShan Road
Shanghai, 200051
CHINA

T: (8621) 6031 9989

F: (8621) 6031 9709

E: information_china@

DJOglobal.com

DENMARK, FINLAND, NORWAY & SWEDEN:

DJO Nordic AB
Murmansgatan 126
21225 Malmö
SWEDEN

T Sweden: 040 39 40 00

T Norway: 8006 1052

T Finland: 0800 114 582

T Denmark: +46 40 39 40 00

E: info.nordic@DJOglobal.com

FRANCE:

DJO France S.A.S.
Centre Européen de Fret
64990 Mouguerre
FRANCE

T: +33 (0)5 59 52 86 90

F: +33 (0)5 59 52 86 91

E: sce.cial@DJOglobal.com

GERMANY:

DJO Deutschland
ORMED GmbH
Merzhauser Str. 112
D-79100 Freiburg
GERMANY

T: +49 761 4566 01

F: +49 761 456655 01

E: infoservice@

DJOglobal.com

ITALY:

DJO Italia Srl
Via Leonardo Da Vinci 97
Trezzano Sul Naviglio
20090 Milano
ITALY

T: +39 02 484 63386

F: +39 02 484 09217

E: it.info@DJOglobal.com

INDIA:

Regus RMZ Milenia
Business Park 2,
Campus 4B, 6th Floor,
No 143, Dr.MGR Road
Perungudi
Chennai-600 096
INDIA

T: +91 44 66915127

E: customercare.india@

DJOglobal.com

SOUTH AFRICA:

DJO South Africa (Pty) Ltd
Unit 1
Brackengate Business Park
5 on London
Brackenfell, 7560
Cape Town
SOUTH AFRICA
T: +27 (0) 87 3102480
F: +27 (0) 86 6098891
E: info.southafrica@
DJOglobal.com

SPAIN:

DJO Ibérica
Carretera de Cornellá 144,
1º 4ª Esplugues de Llobregat,
08950 Barcelona
SPAIN
T: +34 943 638 167
F: +34 943 638 174
E: svc.cial@DJOglobal.com

SWITZERLAND:

Compex Médical SA
Ch. du Dévent
ZI Larges Pièces A
1024 Ecublens
Switzerland
T: +41 (0) 21 695 2360
F: +41 (0) 21 695 2361
E: info@compex.ch

UK & IRELAND:

DJO UK Ltd
1a Guildford Business Park
Guildford
Surrey
GU2 8XG
UNITED KINGDOM
T: +44 (0)1483 459 659
F: +44 (0)1483 459 470
E: ukorders@DJOglobal.com

UNITED STATES:

DJO Global, Inc
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
U.S.A.
T: 1 800 336 6569
F: 1 800 936 6569

DJO GLOBAL, EXPORT CENTERS

ASIA-PACIFIC:

DJO Asia-Pacific Limited
Unit 1905, 19/F, Tower II
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural
Committee Road,
Shatin
HONG KONG
T: +852 3105 2237
F: +852 3105 1444
E: info.asia@DJOglobal.com

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA:

DJO Benelux
Welvaartstraat 8
2200 Herentals
BELGIUM
T: +32 (0) 14248350
F: +32 (0) 14248358
E: info.emea@DJOglobal.com

LATIN AMERICA:

DJO Global, Inc
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
U.S.A.
T: 1 800 336 6569
F: 1 800 936 6569
E: info.latam@DJOglobal.com