

Compat Gastrotube

Gamme Complète de Sondes de Gastrostomie à Ballonnet en Silicone

Les sondes Compat® de gastrostomie à ballonnet sont destinées aux patients qui ont besoin d'une administration entérale intermittente ou continue de nutriments, de liquides ou de médicaments via une stomie bien établie. Elles conviennent également à la décompression gastrique.

Aperçu des Caractéristiques


Les sondes Compat® Gastrotube sont disponibles dans un large choix de tailles (12/14/16/18/20/22/24 FR) et de volumes de ballonnet (5, 10 et 15 cc) pour répondre à la plupart des besoins des patients.

Confort du Patient:

- Avec ballonnet en silicone haute résistance pour favoriser une durée d'utilisation maximale et limiter le remplacement de la sonde
- En silicone souple transparent et biocompatible avec extrémité distale entièrement recouverte par le ballonnet pour préserver la paroi de l'estomac
- Le disque de rétention en silicone avec orifices d'aération et pieds surélevés permet à l'air de circuler autour du site de la stomie pour réduire l'irritation de la peau

Facilité d'Utilisation: Les sondes Compat® Gastrotube intègrent un port de médication ENFit® pour faciliter l'administration des médicaments et sont emballées individuellement dans un emballage stérile.

Sécurité du Patient: Les sondes Compat® Gastrotube comportent des connecteurs ENFit® conçus pour être incompatibles IV afin de contribuer à garantir la sécurité du patient en évitant les erreurs de connexion. Toutes les sondes sont exemptes de DEHP, de BPA et de latex¹.

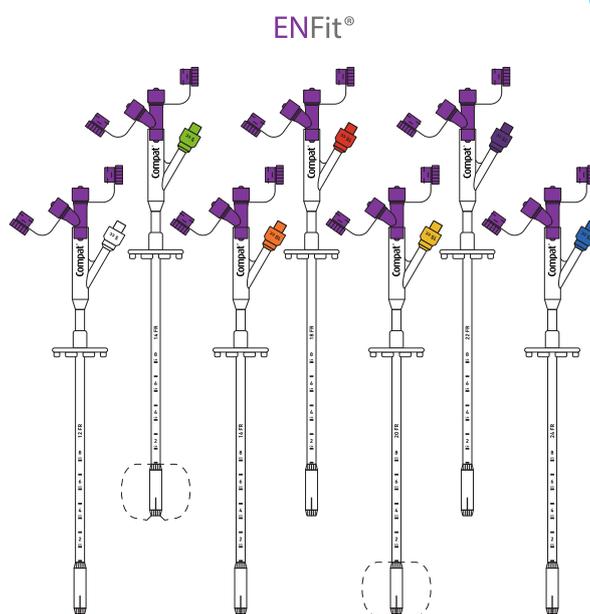


Informations de Commande

Description	Code EAN	Couleur de la valve	Taille du ballonnet	Taille extérieure nominale	Qté	Taille	Longueur	Code LPPR*
Compat® Gastrotube 12 FR	7613287489852		5 cc	Ø 4.0	1	12 FR	± 255 mm	6188660
Compat® Gastrotube 14 FR	7613035356993		5 cc	Ø 4.7	1	14 FR	± 255 mm	
Compat® Gastrotube 16 FR	7613035358805		10 cc	Ø 5.3	1	16 FR	± 255 mm	
Compat® Gastrotube 18 FR	7613035357198		15 cc	Ø 6.0	1	18 FR	± 255 mm	
Compat® Gastrotube 20 FR	7613035357181		15 cc	Ø 6.7	1	20 FR	± 255 mm	
Compat® Gastrotube 22 FR	7613035357174		15 cc	Ø 7.3	1	22 FR	± 255 mm	
Compat® Gastrotube 24 FR	7613035357167		15 cc	Ø 8.0	1	24 FR	± 255 mm	

*Dispositifs médicaux remboursés dans le cadre de la LPPR.

Les Soins aux Patients. Notre Priorité.

Gamme Complète de Sondes de Gastrostomie à Ballonnet en Silicone

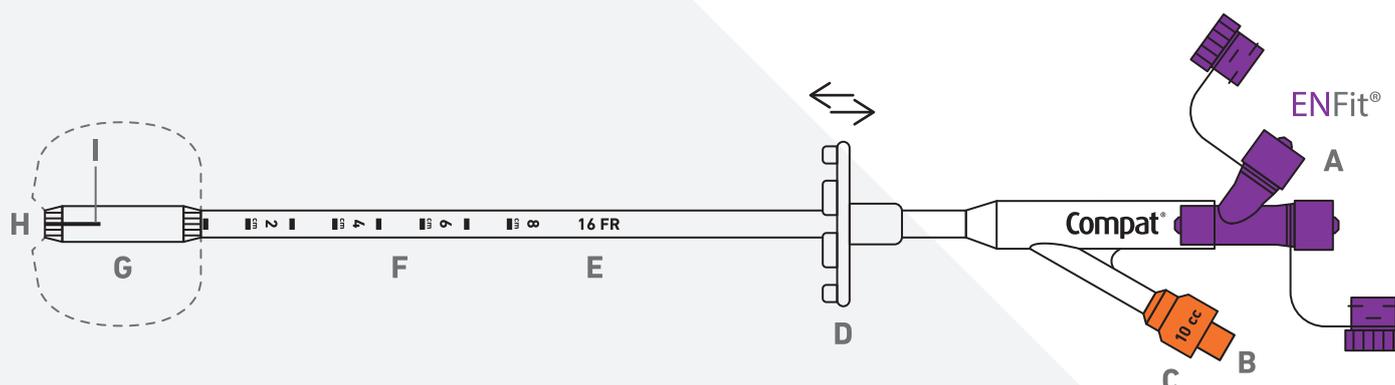

Composants

- A Port de nutrition ENFit® avec port de médication intégré et bouchons à vis
- B Valve de gonflage avec connecteur Luer
- C Taille identifiée avec code couleur et indication du volume du ballonnet
- D Disque de rétention en silicone ajustable de 37 mm de largeur avec orifices d'aération et pieds surélevés
- E Identification de la taille en charrière (FR : French) sur le tube
- F Sonde en silicone souple transparente biocompatible avec repères d'insertion tous les centimètres
- G Ballonnet en silicone haute résistance
- H Extrémité distale arrondie et perméable (extrémité distale en retrait lorsque gonflée)
- I Repère radio-opaque pour le placement et le contrôle de la position

Spécifications

Stérile :	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
Emballage :	Emballé individuellement en carton de 1 pièce (370 x 100 x 40 mm).
Stockage :	Stocker à température ambiante. Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Durée de conservation :	3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation :	Indiqué pour une utilisation à long terme. À usage unique.
Longueur de tube :	Longueur nominale totale : ± 255 mm.
Diamètre du tube :	Diamètre extérieur nominal : de 12 FR (± 4,0 mm) à 24 FR (± 8,0 mm).
Norme ISO :	Raccord ENFit® fabriqué selon la norme ISO 80369-3.
Marquage CE :	Conforme à la directive européenne sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été attribuée par un organisme notifié agréé : TÜV SÜD (CE0123).
Fabricant légal :	Degania Silicone Ltd.
Matériaux :	Silicone. Exempt de DEHP, de BPA et de latex ¹ .

1. Pas de DEHP ni de BPA ajoutés intentionnellement au cours du processus de fabrication. Non formulé avec du latex de caoutchouc naturel.

Dispositifs médicaux de classe IIb marqués CE (0123) destinés à la nutrition entérale. Avant toute utilisation, lire attentivement la notice d'instructions.


Compat®

Nestlé Health Science France S.A.S -
319 543 948 RCS Nanterre,
Issy-Les-Moulineaux

Destiné aux professionnels de santé
0123960 - 07/2021